

ДОГОВОР *Б-059/18*

Днес, 26.02.2018 г. в гр. Шумен между "КОЦ - Шумен" ЕООД с адрес : гр. Шумен, ул. "Васил Априлов" №.63, ЕИК 127521758, представлявано от д-р Сотир Стоянов Караниколов – Управител, наричано по – долу за краткост "ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна

и

„Медицинска Техника Инженеринг" ООД, с адрес: гр.София ж.к.Младост бл.28Б ул.Димитър Моллов №8, ЕИК 831641528 представлявано от Йонка Христова Гетова-Христанова - Управител от друга страна, наричана за краткост по – долу "ИЗПЪЛНИТЕЛ"

на основание чл.112,ал.1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с Решение №028/01.02.2018 г.по преписка №00979-2017-0009 се сключи договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. ИЗПЪЛНИТЕЛ се задължава да достави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** медицински консуматив и / или реактив, наричани по- долу "стоки" съгласно таблица Приложение № 1 неразделна част от настоящия договор за позициите за които кандидатът е класиран на първо място и обявен за изпълнител съгласно Решение на Възложителя.

1.2. При необходимост от прилагане на новосъздадени медицински консумативи и/или реактиви, които отговарят по състав на посочените в Приложение №1 обособени позиции/номенклатури, страните могат с допълнително споразумение да договорят доставката им.

II. ЦЕНИ

2.1. Единичната цена на стоките се определя съгласно таблица Приложение № 1.

2.2. Цената е определена при условията на доставка до краен получател.

2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, освен в случаите по чл.116 от ЗОП.

2.4. Възложителят приема и разглежда искане за изменение или прекратяване на договора(конкретна обособена позиция и/или номенклатура от Приложение 1) само ако Изпълнителят е внесъл в деловодството:

- писмено искане
- приложени писменни доказателства, които обосновават необходимостта от изменение или прекратяване на договора(конкретна обособена позиция и/или номенклатура от Приложение 1)
- проект за анекс за изменение и допълнение на сключения договор.

III. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева, чрез банков превод от страна на **КУПУВАЧА** по следната банкова сметка на **ПРОДАВАЧА**:
BG09UNCR76301000043112
UNCRBGSF

Уни Кредит Булбанк АД

3.2. Заплащането на стоките се извършва, съгласно техническите условия за изпълнение на поръчката, след представяне едновременно на следните документи:

а/ фактура - оригинал или заверено копие

б/ приемно – предавателен протокол – Приложение №2

в/ копие от заявка

3.3. Възложителят извършва заплащането до последното число на месеца, в който изтича 60 дневен срок от датата на фактурата .

IV. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ

4.1. Доставянето на стоките предмет на настоящият договор се извършва по писменна заявка (ежедневни и по спешност) на Възложителя по факс или по електронен път.

4.2. Ежедневните заявки подлежат на изпълнение в срок –до края на работното време на аптеката на Възложителя(8.00-15.30ч.) в деня в който заявката е направена. При невъзможност ежедневната заявка се изпълнява до 3 часа от началото на работното време на следващият работен ден.

4.3. Спешните заявки подлежат на изпълнение до 5 часа, считано от часа на изпращане на заявката ,независимо от работното време на аптека .

V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ

5.1. Място на доставяне на стоките по този договор до краен получател – болнична аптека на “КОЦ-Шумен”ЕООД-гр.Шумен,ул.”В. Априлов”63

5.2. Рискът от случайно погиване или повреждане на стоките преминава върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** от момента на приемането им в мястото на доставяне и подписване на приемно-предавателният протокол.

VI. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ НА СТОКИТЕ

6.1. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са пристигнали при крайните получатели, съгласно приемно-предавателният протокол.

VII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

7.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава:

1. Да достави стоките в договорения срок и да ги предаде придружени с документ показващ остатъчният срок на годност.

2. Да предаде стоките в съответния вид, количество, качество и опаковка в мястото на доставяне.

3. След доставяне на стоките до крайния получател да представи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** фактура съгласно чл. 3.2.б.”а”от настоящия договор.

VIII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

8.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се задължава:

1. Да приеме доставените в срок и на място стоки, съответстващи по вид, количество и качество на описаното в настоящия договор и подпише приемно-предавателният протокол .

2. Да заплати доставените стоки в уговорените срокове.

IX. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ

9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

9.2. При приемане на стоките се подписва приемно-предавателен протокол, удостоверяващ, че стоките са получени.

9.3. В случай, че Изпълнителят е доставил стоката след срока по чл. 4.1., 4.2 и 4.3., това обстоятелство се вписва в приемно-предавателния протокол като се отбелязва точната дата и час на приемане на стоката.

X. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ

10.1. Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на българските стандарти на производителя или еквивалентно.

10.2. Към датата на доставката, остатъчният срок на годност на стоките, предмет на настоящия договор, следва да бъде не по малък от 30%.

XI. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. РЕКЛАМАЦИИ.

11.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да предявява рекламации пред **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за:
а/количество и не комплектност на стоките или техническата документация /явни недостатъци/

б/качество /скрити недостатъци/

- при доставяне на стоки не от договореният вид, посочен в т. 1.1.

- при констатиране на дефекти при експлоатация на стоките

11.2. Рекламации за явни недостатъци на стоките се правят в 14 (четринадесет) дневен срок от датата на доставяне.

11.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да уведоми писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за установените дефекти в 15 (петнадесет) дневен срок от констатирането им.

11.4. В рекламациите се посочват номерът на договора, точното качество на получените стоки и техният фабричен номер, основанието за рекламация и конкретното искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**. Към рекламации те се прилага копие от придружаващата доставката документи.

11.5. В 5 (пет) дневен срок от получаване на рекламацията **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** следва да отговори на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** писмено и конкретно дали приема рекламацията или отхвърля.

11.6. При рекламация за явни недостатъци **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен в едномесечен срок от получаване на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставян на договорените стоки.

11.7. При рекламации за скрити недостатъци **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен в едномесечен срок от получаване на рекламацията да замени стоките без необходимото качество, договорените, за своя сметка и риск или да върне съответната част от заплатената цена, ведно лихвите от деня на получаването.

11.8. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната част от платеното или да се доставят нови стоки принадлежи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, като разходите и рисковите по новото доставяне са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

11.9. Представената гаранция за изпълнение се задържа във всички случаи на виновно неизпълнение на договор за поръчка от изпълнителя, в размер равен на действително претърпените щети. В случай, че Възложителят е направил разходи за осъществяване на дейността си в по-голям размер от размера на гаранцията за изпълнение същият има правото да търси обезщетение от Изпълнителя до размера на действително причинените щети.

11.10. В случай, че Изпълнителят достави стока със закъснение удостоверено по реда на чл. 9.3. във всички случаи заплаща неустойка в размер на 100 лв. за всяко закъснение. Странит приемат, че доставката е изпълнена със закъснение, ако медицинският консуматив и/или реактив е предадено до два часа от изтичане на срока на заявката.

11.11. Неизпълнението на 1 заявка за конкретно медицинското по настоящият договор се счита за основание водещо до директно прекратяване на договора за това по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Договора се счита за прекратен само относно конкретен медицински консуматив и/или реактив, считано от изтичане на последният час от срока за изпълнение на заявката

11.12. Във всички случаи на виновно неизпълнение от страна на Изпълнителя, Възложителят си запазва правото да търси обезвреда до пълния размер на действително причинените щети.

11.13. Гаранциите за изпълнение се освобождават в 30 (тридесет) дневен срок от изтичане срока на договора изцяло или частично ,по банкова сметка посочена от Изпълнителя.

11.14. При доставка на медицински консуматив и/или реактив неотговарящ на характеристиките посочени в Приложение №1, които се считат неразделна част от договора се съставя констативен протокол с описание на констатираните отклонения в доставката. Копие от констативният протокол се връчва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.

В срок от 24 часа, ако Изпълнителят не достави мед. Консуматив и/или реактив съгласно характеристиките посочени в договора, същият се счита автоматично за прекратен за обособената позиция с този ИЗПЪЛНИТЕЛ.

XII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

12.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила.

12.2. Ако, страната е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

12.3. "Непреодолима сила" по смисъла на този договор е непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора.

12.4. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в двуседмичен срок от настъпването на непреодолимата сила.

12.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

12.6. Налице е непреодолима сила във всички случаи на:

- спиране от производство на медицински консуматив и/или реактив включен в Приложение №1 на настоящият договор ;
- прекратяване на разрешително за употреба на територията на страната;
- забрана за внос и продажба на населението от компетентни органи.

12.7. Не представлява "непреодолима сила" събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие.

XIII. СПОРОВЕ

13.1. Възникналите през времетраене на договора спорове и разногласия между страните се решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се превръщат в неразделна част от договора.

13.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според българските материални и процесуални закони от компетентния орган.

XIV. СЪОБЩЕНИЯ

14.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените представители на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**.

14.2. За дата на съобщението се смята:

- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението
- датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата
- датата на приемането – при изпращане по телефакс
- дата и час на приемане - датата и часа на електронното съобщение изпратено от Възложителя/Изпълнителя

14.3. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

МТИ ООД
Гр.София, ж.к. Младост 1, бл.28Б
ул.Д.Моллов
Факс:02/4627128
електронен адрес:
info@mte-bg.com
BG09UNCR76301000043112
UNCRBGSF

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :

„КОЦ-ШУМЕН” ЕООД
Гр.Шумен ул.В. Априлов 63
Факс 054/810 004
електронен адрес
office@oncocenter.org

Банкова сметка
IBAN-
BG19IABG74771000632100
BIC-IABGBGSF
Интернешънъл Асет Банк

Уни Кредит Булбанк АД

14.4. При промяна на обстоятелствата -адрес, телефон, факс или електронен адрес, съответната страна е длъжна незабавно да уведоми другата за промяната.

XV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

15.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор.

15.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско законодателство.

XVI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

16.1. Договорът влиза в сила от 01.03.2018 г.

16.2. Срокът на настоящият договор е до 31.08.2019 г. (18/осемнадесет/ месеца от датата на влизане в сила на договора). В случай, че при изтичане на срока договора Възложителят по обективни причини не е успял да приключи процедурата по определяне на нов доставчик на медицински изделия, настоящият договор продължава да е в сила до окончателното приключване на процедурите и сключването на нов договор. По отношение на „условия, начин на плащане и срок на плащане” срокът на действие е съгласно договореното в Раздел III от настоящия договор.

16.3. Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра на български език – един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и един за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Управител:.....

Гл. Счетоводител:.....


Юрист:.....

Изготвил:..... 23.02.2018

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител МТИ ООД

инж. Йонка Христова Христова-Христанова

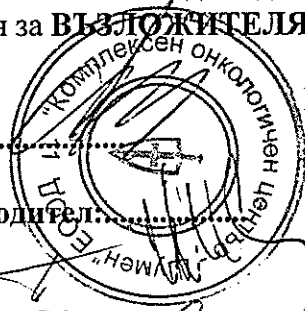

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

МО - ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ №

.....г., в изпълнение на договор №.....за доставка на.....фирма "....."
 доставител....., на длъжностсклад, тел....., и краен получател аптека на "КОЦ-ШУМЕН" ЕООД, лаборатория..
 адрес: гр.Шумен ул.В.Априлов 63, представявано от....., МОЛ/упълномощено лице/ на длъжност Управител аптека, тел.....
 ршиха предаването и приемането на следното:


| Юр.№ | Продукт | Партиден № | Количество | | Годен до дата/Месец/Година | Остатъчен срок | | Единична цена по договор в лв. с вкл. ДДС |
|------|---------|------------|------------|----------|----------------------------|----------------|-----|--|
| | | | Заявено | Получено | | в месеци | в % | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Л.....
 /...../


ПРЕДАЛ.....
 /...../

Първи места на участниците по процедура с предмет: Доставка на медицински консумативи и реактиви по Приложение 1 за нуждите на "КОЦ- Шумен" ЕООД за обособена позиция №


| Номенклатурна група | Наименование | Характеристика | Единица мярка | Ориентировъчно количество за 18 месеца | Производител | Участник | Предлага на опаковка | Цена за ед.мярка с ДДС /брой, метър, флакон, тест и др./ | Обща стойност за опаковка с ДДС | Стойност взета в предвид при класирането | Класиране ране | Стойност на договора без ДДС | ГИ 5% |
|---------------------|--|---|---------------------|--|--|----------|----------------------|--|---------------------------------|--|----------------|------------------------------|--------|
| 13 | хирургична лента 9.1 м x 5 см | хирургична лента 9.1 м x 5 см | брой ролка | 500 | Eurofam- Италия | МТИ ООД | 12 | 2,52000 | 30,24 | 2,52000 | 1 | 1050,00 | 52,50 |
| 23 | Стерилна самофиксираща се превръзка 7.2 x 5 см | От 100% полиестерен нетъкан материал с незалепваща подложка от абсорбираща вискоза, адхезив без колофон; със заоблени краища, размер 7.2 x 5 см, с подложка 4 x 2,5 см, 50 бр./опаковка | опаковане по 50 бр. | 100 | Eurofam- Италия | МТИ ООД | 100 | 3,30000 | 6,60 | 3,30000 | 1 | 275,00 | 13,75 |
| 60 | Сет | За нефростома | бр. | 10 | Coloplast Porges/ Дания | МТИ ООД | 1 | 123,60000 | 123,60 | 123,60000 | 1 | 1030,00 | 51,50 |
| 65 | Дренаж гофриран латекс | 36/6 | бр. | 20 | Coloplast Porges/ Дания | МТИ ООД | 1 | 7,20000 | 7,20 | 7,20000 | 1 | 120,00 | 6,00 |
| 66 | Дренаж гофриран латекс | 23/5 | бр. | 20 | Coloplast Porges/ Дания | МТИ ООД | 1 | 39,60000 | 39,60 | 39,60000 | 1 | 660,00 | 33,00 |
| 74 | Микроконтейнери за периферна кръв с EDTA за кръвна картина | комплект с дозираша капилярка-200мкл | бр. | 20000 | КАВЕ-Германия/комплект с дозираша капилярка-200мкл | МТИ ООД | 100 | 0,30000 | 30,00 | 30,00000 | 1 | 5000,00 | 250,00 |

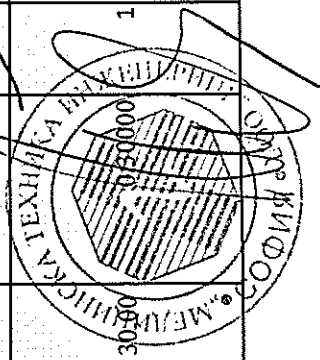


| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|-----|-------|--|---------|-----|---------|-------|---------|---|---------|--------|
| 75 | Микроконгейне ри за периферна кръв за серум | комплект с дозираща каплярка-200мкл | бр. | 300 | КАВЕ- Германия/ комплект с дозираща каплярка- 200мкл | МТИ ООД | 100 | 0,28260 | 28,26 | 0,28260 | 1 | 70,65 | 3,53 |
| 76 | епруветки за серум за биохимия | аспирация с бутало- 2,6 мл. | бр. | 22000 | КАВЕ- Германия/ аспирация с бутало 2,6 мл. | МТИ ООД | 50 | 0,28200 | 14,10 | 0,28200 | 1 | 5170,00 | 258,50 |
| 77 | епруветки за серум за биохимия | аспирация с бутало- 4,4 мл | бр. | 27000 | КАВЕ- Германия/ аспирация с бутал 4,4 мл | МТИ ООД | 50 | 0,28200 | 14,10 | 0,28200 | 1 | 6345,00 | 317,25 |
| 78 | епруветки за серум за биохимия | аспирация с бутало - 7,5 мл. | бр. | 1000 | КАВЕ- Германия/ аспирация с бутало 7,5 мл. | МТИ ООД | 50 | 0,28200 | 14,10 | 0,28200 | 1 | 235,00 | 11,75 |
| 79 | епруветки за хемостаза | аспирация с бутало - 2,9мл | бр. | 6000 | КАВЕ- Германия/ аспирация с бутало 2,9мл | МТИ ООД | 50 | 0,30000 | 15,00 | 0,30000 | 1 | 1500,00 | 75,00 |
| 80 | епруветки за СУЕ | аспирация с бутало | бр. | 500 | КАВЕ- Германия/ аспирация с бутало | МТИ ООД | 50 | 0,46000 | 23,00 | 0,46000 | 1 | 191,67 | 9,58 |
| 81 | Епруветка за СУЕ | по Вестергринн 3.5 мл к-т с луер накрайник | бр. | 500 | КАВЕ- Германия/ по Вестергри инн 3.5мл к- т с луер накрайник | МТИ ООД | 50 | 0,46000 | | | 1 | 191,67 | 9,58 |

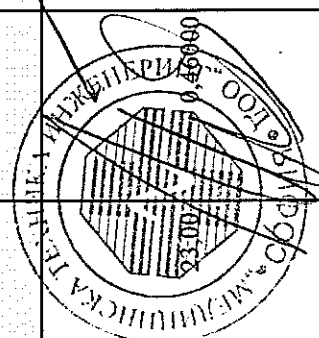


| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------|--|-----|-------|---|---------|-----|---------|-------|---------|---|---------|--------|
| 82 | Епруветка за плазма | Li heparin 2.0 - 3.0 мл | бр. | 500 | КАВЕ-Германия/ Li heparin 2.0 - 3.0 мл | МТИ ООД | 50 | 0,32000 | 16,00 | 0,32000 | 1 | 133,33 | 6,67 |
| 83 | Игли комплект с холдери | № 20G-№ 21G № 22 22Стерилни съвместими с епруветките за серум и биохимия | бр. | 23000 | КАВЕ-Германия/ стерилни комплект с холдери 20G-№ 21G № 22 | МТИ ООД | 100 | 0,30000 | 30,00 | 0,30000 | 1 | 5750,00 | 287,50 |
| 84 | Адаптер | за инжекции към епруветките | бр. | 200 | КАВЕ-Германия/ адаптер за инжекции към епруветките | МТИ ООД | 100 | 0,15000 | 15,00 | 0,15000 | 1 | 25,00 | 1,25 |
| 85 | Адаптер | за абокати към епруветките | бр. | 200 | КАВЕ-Германия/ адаптер за абокати към епруветките | МТИ ООД | 100 | 0,31000 | 31,00 | 0,31000 | 1 | 51,67 | 2,58 |
| 92 | Стопери | Комбиниран стопер за катетри и спринцовки (uer lock/uer slip, мъжко/женско), червен син или бял цвят за лесно разпознаване, 100 броя в кутия | бр. | 2000 | KDM-Германия | МТИ ООД | 200 | 0,06900 | 13,80 | 0,06900 | 1 | 115,00 | 5,75 |

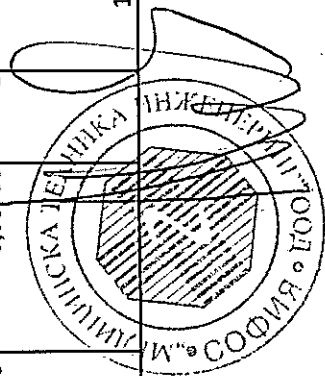

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|---|---------------------------|-----|----------------------------|---------|-----------------|---------|-------|---------|---|---------|--------|------|
| 94 | Трипътно кранче | Трипътно кранче с налягане до 4 bar, въртене на 360°, радиално и аксиално подвижно фиксиране, прозрачен корпус, без удължител, различни цветове, устойчиво на емулсии, цитостатични и агресивни медикаменти | бр. | 500 | KDM-Германия | МТИ ООД | 1 | 0,30000 | 0,30 | 0,30000 | 1 | 0,30000 | 125,00 | 6,25 |
| 121 | Катетри уретерални | № 4, 5, 6, 7 | бр. | 10 | Coloplast Porges/ Дания | МТИ ООД | 1 | 8,88000 | 8,88 | 8,88000 | 1 | 8,88000 | 74,00 | 3,70 |
| 136 | Деконтаминираща постелка | Многопластово антибактериално покритие има бактериостатични и антимикробни свойства. Съдържа 1,2 Benzisotiazolin -3. Ефективен срещу бактерии, гъбички и дрожди. 45x115 Цвят син или зелен. Състояща се от 30 | опаков ка по 30 бр. | 2 | Sterylub-Италия | МТИ ООД | опак. по 30 бр. | 44,40 | 44,40 | 44,40 | 1 | 44,40 | 74,00 | 3,70 |

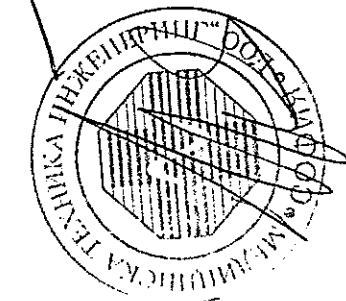


| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--------------|------|----------------------|---------|-------------|------|---------|---|---------|--------|
| 138 | Нестерилни ръкавици от синтетичен нитрил с вътрешно полимерно покритие, без съдържание на латекс и пудра, грапави в областта на пръстите, силно еластични и устойчиви на късане, дължина 240 мм, дебелина 0,10 мм, цвят- бял, 100 бр./оп. | оп 100бр. | 300 | Veromed- Германия | МТИ ООД | оп. 100 бр. | 5,52 | 5,52 | 1 | 1380,00 | 69,00 |
| 142 | Нестерилни ръкавици - латексови с пудра | оп 100бр. | 1200 | Veromed- Германия | МТИ ООД | оп. 100 бр. | 4,50 | 4,50000 | 1 | 4500,00 | 225,00 |

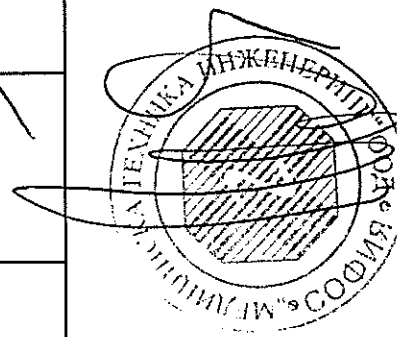


| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|-----------|------|----------------------------|---------|------|----------|-------|----------|---|---------|--------|
| 145 | Хирургични стерилни ръкавици № 6, 6.5, 7, 7.5, 8 | От натурален гумен латекс покрити с алое вера, с полимерен слой против навлажняване на ръцете с микровлакна с двойна защита и с маншет против смъкване № 6, 6.5, 7, 7.5, 8 по 50 в опаковка. | чифт | 1200 | WRP - Малайзия | МТИ ООД | 1,62 | 1,00000 | 1,62 | 1,00000 | 1 | 1000,00 | 50,00 |
| 146 | Хирургични стерилни ръкавици № 6, 6.5, 7, 7.5, 8 | От натурален гумен латекс, с полимерен слой против навлажняване на ръцете с микровлакна с двойна защита и с маншет против смъкване № 6, 6.5, 7, 7.5, 8 по 50 вопаковка | чифт | 5000 | WRP - Малайзия | МТИ ООД | 1,08 | 1,00 | 1,08 | 1,00000 | 1 | 4166,67 | 208,33 |
| 165 | Еднократни стерилни 3-слойни операционни чаршафи 150 x 175 см, 9 бр./кашон | От мек нетъкан материал, възпрепятстващи преминаването на течности и бактерии, с лепяща част 150 x 175 см, 9 бр./кашон | бр. | 30 | Bastos Viegas - Португалия | МТИ ООД | 8 | 6,00 | 48,00 | 6,00000 | 1 | 150,00 | 7,50 |
| 168 | Антимикробно инцизионно фолио 15 x 20 см. | с размер на отвора 10 x 20 см. | бр./кутия | 10 | Eurofap - Италия | МТИ ООД | 1 | 3,24000 | 3,24 | 3,24000 | 1 | 27,00 | 1,35 |
| 169 | Антимикробно инцизионно фолио 44 x 35 см. | с размер на отвора 34 x 35 см. | бр./кутия | 10 | Eurofap - Италия | МТИ ООД | 1 | 5,76000 | | 5,76000 | 1 | 48,00 | 2,40 |
| 170 | Антимикробно инцизионно фолио 56 x 60 см. | с размер на отвора 56 x 60 см. | бр./кутия | 10 | Eurofap - Италия | МТИ ООД | 1 | 11,34000 | | 11,34000 | 1 | 94,50 | 4,73 |


| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---------------|------|--------------------|---------|----|----------|-------|----------|---|--------|-------|
| 171 | Антимикробно инициционно фолио 56 x 85 см. | с размер на отвора 56 x 85 см. | бр./ кутия | 10 | Еurofam- Италия | МТИ ООД | 1 | 14,94000 | 14,94 | 14,94000 | 1 | 124,50 | 6,23 |
| 195 | Аспиратор за многодозови флакони | с интегрирана възвратна клапа, снабден с въздушен компенсатор с 0.45µm бактериален филтър и 5µm филтър за частици; капаче за покриване на аспирационния порт. | бр. | 1000 | KDM- Германия | МТИ ООД | 1 | 1,17000 | 1,17 | 1,17000 | 1 | 975,00 | 48,75 |
| 251 | игли хирургични | GR от000 до16 федерирашо ухо | дузина | 10 | TNI- Германия | МТИ ООД | 12 | 8,16000 | 8,16 | 8,16000 | 1 | 68,00 | 3,40 |
| 254 | Игли хирургически | PB от 00 до 8 федерирашо ухо | дузина | 10 | TNI- Германия | МТИ ООД | 12 | 8,16000 | 8,16 | 8,16000 | 1 | 68,00 | 3,40 |
| 258 | игли хирургични | Игла хирургична, мускулна, кръгла, 1/2 кръг, от 34 до 63 см., висококачествена стомана. GR | дузина | 10 | TNI- Германия | МТИ ООД | 12 | 13,20000 | 13,20 | 13,20000 | 1 | 110,00 | 5,50 |
| 259 | игли хирургични | Игла хирургична, мускулна, режеща, 1/2 кръг, от 20 до 54 см., висококачествена стомана. R | дузина | 10 | TNI- Германия | МТИ ООД | 12 | 14,28000 | 14,28 | 14,28000 | 1 | 119,00 | 5,95 |
| 260 | игли хирургични | Игла хирургична, кожна, режеща, 3/8 кръг, от 20 до 54 см., висококачествена стомана. B | дузина | 10 | TNI- Германия | МТИ ООД | 12 | 14,28000 | 14,28 | 14,28000 | 1 | 119,00 | 5,95 |
| 261 | игли хирургични | Игла хирургична, кожна, кръгла, 1/2 кръг, от 26 до 45 см., висококачествена стомана. GAR | дузина | 10 | TNI- Германия | МТИ ООД | 12 | 14,28000 | 14,28 | 14,28000 | 1 | 119,00 | 5,95 |
| 262 | игли хирургични | Игла хирургична, чревна, кръгла, 1/2 кръг, от 18 до 30 см., висококачествена стомана. DB | дузина | 10 | TNI- Германия | МТИ ООД | 12 | 13,20000 | 13,20 | 13,20000 | 1 | 110,00 | 5,50 |

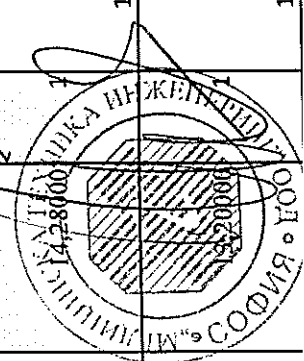


| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|--|------------|---------------------------------------|---------|-----|----------|-------|----------|---|--------|-------|
| 263 | Игли хирургични | Игла хирургична, чревна, кръгла, 5/8 кръг, от 18 до 30 см., висококачествена стомана, PH | дължина 10 | TNI-Германия | МТИ ООД | 12 | 14,28000 | 14,28 | 14,28000 | 1 | 119,00 | 5,95 |
| 264 | Игли хирургични | С федериращо ухо от високо качествена стомана с триъгълен външно режещ връх GA от 000 до 16 | дължина 10 | TNI-Германия | МТИ ООД | 12 | 28,68000 | 28,68 | 28,68000 | 1 | 239,00 | 11,95 |
| 265 | Игли хирургични | С федериращо ухо от високо качествена стомана с триъгълен външно режещ връх GAR от 000 до 16 | дължина 10 | TNI-Германия | МТИ ООД | 12 | 15,60000 | 15,60 | 15,60000 | 1 | 130,00 | 6,50 |
| 266 | Игли хирургични | С федериращо ухо от високо качествена стомана с триъгълен външно режещ връх G от 000 до 16 | дължина 10 | TNI-Германия | МТИ ООД | 12 | 15,60000 | 15,60 | 15,60000 | 1 | 130,00 | 6,50 |
| 267 | Игли хирургични | С федериращо ухо от високо качествена стомана с триъгълен външно режещ връх GR от 000 до 16 | дължина 10 | TNI-Германия | МТИ ООД | 12 | 14,28000 | 14,28 | 14,28000 | 1 | 119,00 | 5,95 |
| 276 | Контейнери | стерилни 40 мл | бр. 3000 | Firatmed-Турция 10-40 мл. 887000010 2 | МТИ ООД | 100 | 0,11040 | 11,04 | 0,11040 | 1 | 276,00 | 13,80 |
| 277 | Контейнери | стерилни 30 мл | бр. 3000 | Firatmed-Турция 10-40 мл. 887000010 2 | МТИ ООД | 100 | 0,11040 | 11,04 | 0,11040 | 1 | 276,00 | 13,80 |
| 282 | ЕКГ хартия | апарат "Шилер АГ" 101-80/70/315 | бр. 100 | Ceracarta-Италия | МТИ ООД | 1 | 2,64000 | 2,64 | 2,64000 | 1 | 220,00 | 11,00 |
| 285 | ЕКГ хартия | апарат "Шилер АГ" - 2 PLUS/CS200/-210/280/215 | бр. 70 | Ceracarta-Италия | МТИ ООД | 1 | 9,36000 | 9,36 | 9,36000 | 1 | 546,00 | 27,30 |

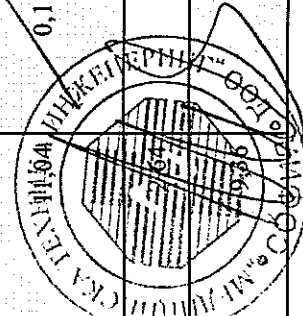


| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|-------------------|----|--|---------|-------------------|--------|--------|-----------|---|--------|-------|
| 320 | Бови дик тест DIN A4 | еднократен тест с промяна на цвета след стерилизационния цикъл показващ възможни проблеми на стерилизатора | 100 бр в кутия | 4 | VP Stericlin, Германия | МТИ ООД | 100 бр в кутия | 165,60 | 165,60 | 165,60000 | 1 | 552,00 | 27,60 |
| 321 | Индикаторни ленти | за контрол на стерилизацията за пара за 121 и 134 градуса с промяна в цвета след стерилизационния цикъл | 250 бр в кутия | 6 | InfomerM ед, Полша / SPS, САЩ | МТИ ООД | 250 бр в кутия | 24,00 | 24,00 | 24,00000 | 1 | 120,00 | 6,00 |
| 323 | Адхезивна лента без индикатор за стерилизация /лепенка/ | 25мм/50м | ролка | 20 | VP Stericlin, Германия | МТИ ООД | 1 ролка | 3,72 | 3,72 | 3,72000 | 1 | 62,00 | 3,10 |
| 324 | Ролки гладко фолио за стерилизация с 3 индикатора за пара, формалдехид етиленов окис с размер 7,5/200 м | съответствие с всички международни стандарти, както следва - EN ISO11607 и EN 868 за опаковашите материали и EN ISO 11140 / EN 867 за индикаторите. ISO 9001; 70g/m ² плътност на медицинската хартия | ролка | 4 | Medifit, Италия | МТИ ООД | 1 ролка | 22,80 | 22,80 | 22,80000 | 1 | 76,00 | 3,80 |

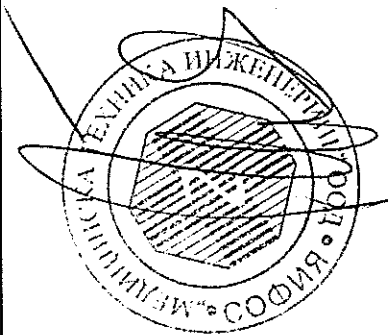


| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|-----------|-----|-------------------|---------|---------|----------|-------|----------|---|--------|-------|
| 326 | Ролки гладко фолио за стерилизация с 3 индикатора за пара, формалдехид етиленов окис размер 20/200 м | съответствие с всички международни стандарти, както следва - EN ISO11607 и EN 868 за опаковашите материали и EN ISO 11140 / EN 867 за индикаторите. ISO 9001; 70g/m ² плътност на медицинската хартия | ролка | 4 | Medifit, Италия | МТИ ООД | 1 ролка | 56,40000 | 56,40 | 56,40000 | 1 | 188,00 | 9,40 |
| 327 | Ролки гладко фолио за стерилизация с 3 индикатора за пара, формалдехид етиленов окис размер 30/200 м | съответствие с всички международни стандарти, както следва - EN ISO11607 и EN 868 за опаковашите материали и EN ISO 11140 / EN 867 за индикаторите. ISO 9001; 70g/m ² плътност на медицинската хартия | ролка | 4 | Medifit, Италия | МТИ ООД | 1 ролка | 86,40000 | 86,40 | 86,40000 | 1 | 288,00 | 14,40 |
| 2 | Принтерна хартия за ехограф-K61B 110 мм. х 20 м. Ролка | Принтерна хартия за ехограф-Mitsubishi K61B 110 мм. х 20 м. Ролка | опак. | 52 | Сегасарта-Италия | МТИ ООД | 1 | 54,96 | 13,74 | 13,74 | 1 | 595,40 | 29,77 |
| 29 | Покривни стъкла 24 x 24 мм | Опаковка от 100 бр. | опаков ка | 100 | Biosigma - Италия | МТИ ООД | 200 | 1,65 | 3,30 | 1,65 | 1 | 137,50 | 6,88 |
| 30 | Покривни стъкла 20 x 20 мм | Опаковка от 100 бр. | опаков ка | 100 | Biosigma - Италия | МТИ ООД | 200 | 1,35 | 2,70 | 1,35 | 1 | 112,50 | 5,63 |
| 31 | Покривни стъкла 24 x 36 мм | Опаковка от 100 бр. | опаков ка | 150 | Biosigma - Италия | МТИ ООД | 100 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 1 | 307,50 | 15,38 |

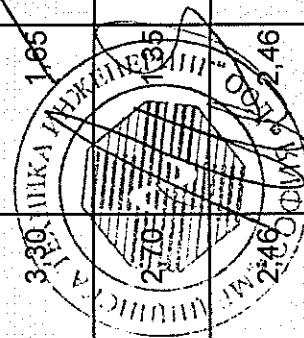


| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------------------|--------------|------|---|------------|----------|-------|--------|-------|---|---------|-------|
| 32 | Покривни стъкла 24 x 50 мм | Опаковка от 100 бр. | опаков ка | 150 | Biosigma - Италия | МТИ ООД | 100 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 1 | 367,50 | 18,38 |
| 34 | Касети хистологични със странични прорези за по- добра обмяна на реактивите, 45° наклон на повърхността за надписване. | | бр | 1000 | Leica, Германия (art.No. 39CL-550- X) | МТИ ООД | 1000 бр. | 0,14 | 140,00 | 0,14 | 1 | 116,67 | 5,83 |
| 39 | Декалцира ща течност бърз разтвор | Опаковка до 1 л. | л | 1 | Leica, Германия (art.No.38 00421E) | МТИ ООД | 1 л | 22,80 | 22,80 | 22,80 | 1 | 19,00 | 0,95 |
| 40 | Декалцира ща течност с едновременна фиксация | Опаковка до 1 л. | л | 2 | Leica, Германия (art.No.38 00401) | МТИ ООД | 1 л | 21,60 | 21,60 | 21,60 | 1 | 36,00 | 1,80 |
| 42 | Ксилол хистологичен | Опаковка до 5 л. | л | 60 | Avantor- Baker Mallincro dt- Холанди я | МТИ ООД | 5 | 7,80 | 39,00 | 7,80 | 1 | 390,00 | 19,50 |
| 44 | Формалдеhid 10% неутрално буферран, за хистология | Опаковка до 5 л. | л | 300 | Avantor- Baker Mallincro dt- Холанди я | МТИ ООД | 10 | 4,32 | | | 1 | 1080,00 | 54,00 |

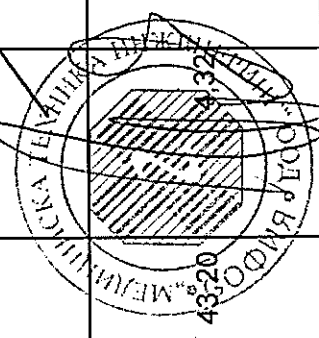


| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------|--------------------|-----|-----|---|------------|--------|--------|--------|--------|---|--------|------|
| 46 | Вопин фиксатор | Опаковка до 2.5 л. | л | 2,5 | BioGnost, Хърватск а (art.No. BOU-OT-1L) | МТИ ООД | 1 л | 29,40 | 29,40 | 29,40 | 1 | 61,25 | 3,06 |
| 50 | Лепило за покривни стъкла | Опаковка до 500 мл | бр. | 4 | Leica, Германия (art.No.38 08600E) | МТИ ООД | 500 ml | 37,80 | 37,80 | 37,80 | 1 | 126,00 | 6,30 |
| 59 | Еднократни пипети Пастъор, 1 мм | | бр | 200 | Biosigma - Италия/ Еднократни пипети Пастъор, 1 мм | МТИ ООД | 500 | 0,035 | 17,50 | 0,035 | 1 | 5,83 | 0,29 |
| 60 | Еднократни пипети Пастъор, 2 мм | | бр | 200 | Biosigma - Италия/ Еднократни пипети Пастъор, 3 мм | МТИ ООД | 500 | 0,035 | 17,50 | 0,035 | 1 | 5,83 | 0,29 |
| 61 | Еднократни пипети Пастъор, 3 мм | | бр | 200 | Biosigma - Италия/ Еднократни пипети Пастъор, 3 мм | МТИ ООД | 500 | 0,035 | 17,50 | 0,035 | 1 | 5,83 | 0,29 |
| 88 | Маркер за ИХХ | | бр | 1 | Leica, Германия (art.No. PE N) | МТИ ООД | 1 бр. | 124,80 | 124,80 | 124,80 | 1 | 104,00 | 5,20 |

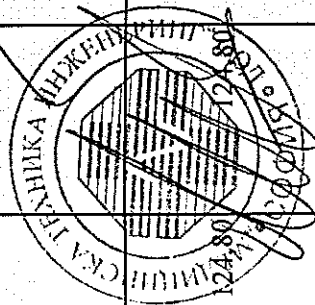


| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|--|--------------|----|---|------------|----------------------------------|-----------------|--------|--------|---|--------|------|
| 105 | Оцветител по Perls | | кит | 1 | BioGnost, Хърватск 1 а (art.No.H P-100T) | МТИ ООД | 1 кит / опак. от 100 теста | 103,20 | 103,20 | 103,20 | 1 | 86,00 | 4,30 |
| 12 | Тест ленти за алб. + захар | Тест ленти EM- Combina 2 GP за алб. + захар, кат. N: E22023 | опаков ка | 20 | Analytico п - Германи я/ глюкоза и протеин | МТИ ООД | 100 | 6,60/100б р. | 6,60 | 6,60 | 1 | 110,00 | 5,50 |
| 13 | Тест ленти за кето тела | Тест ленти EM- Combina K за кето тела кат. N: E22093 | опаков ка | 4 | Analytico п - Германи я глюкоза, аскорбин ова киселина , кетони | МТИ ООД | 100 | 6,60/100б р. | 6,60 | 6,60 | 1 | 22,00 | 1,10 |

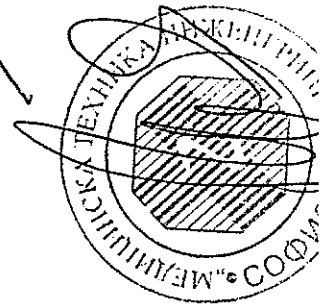


| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|--|--------------|---|---|------------|-----|---------------------|-------|-------|---|--------|------|
| 14 | Тест ленти бил. + уробил. | Тест ленти EM- Combina 2 BU бил. + уробил. Кат. N: E22024 | олаков ка | 5 | Аналитико н - Германи я/ Combi Screen 11SYS, глюкоза, аскорбин ова киселина , кетони, протеин, PH, кръв, нитрити, левкоцит и, специфи чно тегло, билируб ин, уробили ноген | МТИ ООД | 150 | 20,64/ 100бр.оп. | 30,96 | 30,96 | 1 | 129,00 | 6,45 |
|----|------------------------------|--|--------------|---|---|------------|-----|---------------------|-------|-------|---|--------|------|

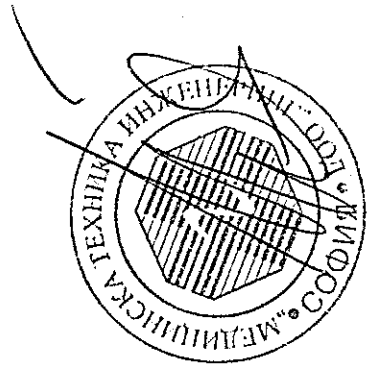

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|-------------|---|--|---------|-------|-----------------|-------|---------|---|--------|------|
| 15 | Тест ленти, 11 показателя, комбинирани с левкоцити и отн. г. | Тест ленти BM-Combina 11 (pH, протеин, глюкоза, кръв, кетони, билирубин, уробилиноген, отн. тегло, нитрити, левкоцити, аскорбинова к-на) кат. N: E22112 | опаков ка | 4 | Analytico Германия Combi Screen 11SYS, глюкоза, аскорбин ова киселина, кетони, протеин, PH, кръв, нитрити, левкоцит и, специфично тегло, билирубин, уробилиноген | МТИ ООД | 150 | 20,64/100бр.оп. | 30,96 | 30,96 | 1 | 103,20 | 5,16 |
| 28 | Хемаколор - експресна боя | | оп. 3 x 500 | 1 | Bio Gnost - Хърватска | МТИ ООД | 3x500 | 72,00000 | 72,00 | 72,00 | 1 | 60,00 | 3,00 |
| 29 | C - реактивен протеин | | тест | 2 | CRP - BioSyste ms/ Испания | МТИ ООД | 150 | 0,17000 | 25,50 | 0,17000 | 1 | 0,28 | 0,01 |

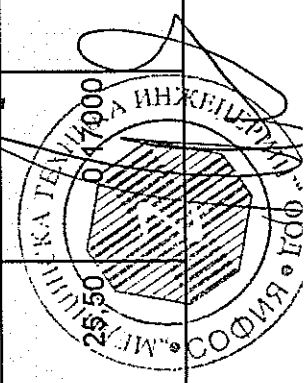


| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--------------|------|---|------------|--------|-----------|--------|----------|---|---------|--------|
| 30 | Ангистрепгол изингов титър латексова проба | опаков ка | 1 | ASO - BioSyste ms/ Испания | МТИ ООД | 150 | 25,50000 | 25,50 | 25,50 | 1 | 21,25 | 1,06 |
| 34 | Контрол за HDL холестерол | опаков ка | 2 | HDL cho. Control - BioSyste ms/ Испания | МТИ ООД | 3x1мл. | 37,20000 | 37,20 | 37,20000 | 1 | 62,00 | 3,10 |
| 35 | Калибратор за HDL хол. | опаков ка | 2 | BioSyste ms/ Испания/ ХОЛЕСТ ЕРОЛ HDL/LDL CALIBRA TOR 1ml. | МТИ ООД | 1мл. | 7,50000 | 7,50 | 7,50000 | 1 | 12,50 | 0,63 |
| 36 | Количество белтък в урината | опаков ка | 1 | BioSyste ms/ Испания | МТИ ООД | 4x60 | 26,16000 | 26,16 | 26,16 | 1 | 21,80 | 1,09 |
| 37 | Статив за контейнери за СУЕ - „Грейнер“ | бр. | 1 | Статив за СУЕ Грайнер | МТИ ООД | 1 | 51,00000 | 51,00 | 51,00 | 1 | 42,50 | 2,13 |
| 38 | Стъкла за натривки | бр. | 1500 | Biosigma - Италия | МТИ ООД | 50 | 0,04500 | 0,045 | 0,045 | 1 | 56,25 | 2,81 |
| 39 | С-реактив Протеин калибратор за алфа васерман | опаков ка | 8 | Alfa Wasserm app - Холанди я | МТИ ООД | 6x1 | 420,00000 | 420,00 | 420,00 | 1 | 2800,00 | 140,00 |

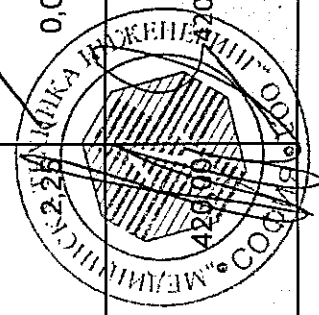

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|----------------------|-------|------|--|------------|---------------------|-----------|--------|-----------|---|---------|--------|
| 40 | Жълти наконечници | | бр. | | 5000 | Biosigma - Италия/ жълти връхчета за автомат ични пилети | МТИ ООД | 1000 | 0,00960 | 9,60 | 0,00960 | 1 | 40,00 | 2,00 |
| 41 | Микроконтей нери за периферна кръв с ЕДТА с капилярки | | бр. | 10000 | | КАВЕ- Германи я/ компект с дозиращ а капилярк а-200мкл | МТИ ООД | 100 | 0,30000 | 30,00 | 0,30 | 1 | 2500,00 | 125,00 |
| 42 | Сини наконечници | | бр. | 3000 | | Biosigma - Италия | МТИ ООД | 1000 | 0,01330 | 13,30 | 0,01330 | 1 | 33,25 | 1,66 |
| 43 | Пикочна киселина | | | 6 | | Uric Acid BioSyste ms/ Испания | МТИ ООД | 1x200ml./ 1x5ml. | 18,00000 | 18,00 | 18,00000 | 1 | 90,00 | 4,50 |
| 58 | Микроковети и магнитни бъркалки | | ол. х 1000 бр. | 3 | | Biosigma - Италия/ BSA77 | МТИ ООД | 1000 | 292,60000 | 292,60 | 292,60000 | 1 | 731,50 | 36,58 |
| 59 | Тромбопласти н стандартизира н Technoplastin | | | 10 | | Dutch Diadnosti cs B.V./Хол андия | МТИ ООД | 10x2 | 30,00000 | | | 1 | 250,00 | 12,50 |




| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------------|---|----------------------------------|---------|---|----------|--------|----------|---|--------|------|
| 60 | APTT - течно | оп. 2 x 5 мл. | 6 | Dutch Diadnosti cs B.V./Холандия | МТИ ООД | APTT 6x2.5/1x15 CaCL | 15,20000 | 45,60 | 15,20000 | 1 | 76,00 | 3,80 |
| 61 | Фибриноген | оп. 5 x 5 мл. | 7 | Dutch Diadnosti cs B.V./Холандия | МТИ ООД | Fibrinogen 10x1 ml/ 2x60 Imimidazole buffer/ 1x1ml control plasma | 21,92000 | 114,00 | 21,92000 | 1 | 127,87 | 6,39 |
| 62 | Контролна плазма - нормал с обявена % активност ПВ, АПТТ секунди. Фибриноген - г/л | оп. 5 x 1 мл. | 5 | BioSyste ms/ Испания | МТИ ООД | 4x1 | 30,00000 | 24,00 | 30,00000 | 1 | 125,00 | 6,25 |
| 63 | Контролна плазма - анормал с обявена % активност ПВ, АПТТ секунди, фибриноген - г/л | оп. 5 x 1 мл. | 2 | BioSyste ms/ Испания | МТИ ООД | 4x1 | 30,00000 | 24,00 | 30,00000 | 1 | 50,00 | 2,50 |
| 64 | Калибрационна плазма | оп. 5 x 1 мл. | 1 | BioSyste ms/ Испания | МТИ ООД | 4x1 | 56,25000 | 45,00 | 56,25000 | 1 | 46,88 | 2,34 |

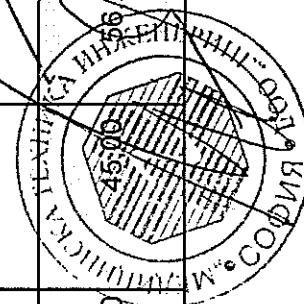

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|-----------------|-----|------------------------------|---------|----------|-----------|--------|--------|---|---------|--------|
| 65 | Калциев хлорид 25 ммол/л | БИОЛАВО Буфер за каолин кефалиново време (CaCl 0.025M) (60 ml) | разтво р/мл. | 100 | BioSyste ms/ Испания | МТИ ООД | 4x16 | 0,34375 | 22,00 | 22,00 | 1 | 1833,33 | 91,67 |
| 66 | Имидазол буфер | | оп. х 90 мл. | 4 | BioSyste ms/ Испания | МТИ ООД | 4x15 | 90,00000 | 60,00 | 60,00 | 1 | 200,00 | 10,00 |
| 73 | Съгълени пипети лабораторни, крайни-5.0 мл. | | бр | 20 | Heinz Herentz/ Германи я | МТИ ООД | 1 | 2,20000 | 2,20 | 2,20 | 1 | 36,67 | 1,83 |
| 74 | стъклени пипети лабораторни, крайни-10.0 мл. | | бр | 20 | Heinz Herentz/ Германи я | МТИ ООД | 1 | 2,40000 | 2,40 | 2,40 | 1 | 40,00 | 2,00 |
| 82 | ЖСК | | опаков ка | 2 | Alfa Wasserm ann - Холанди я | МТИ ООД | 3x30/1x5 | 186,00000 | 186,00 | 186,00 | 1 | 310,00 | 15,50 |
| 86 | C-реактивен протеин | | опаков ка | 5 | Alfa Wasserm ann - Холанди я | МТИ ООД | 4x12/1x8 | 296,40000 | 296,40 | 296,40 | 1 | 1235,00 | 61,75 |
| 89 | Контролен серум CRP | | 3x1 опаков ка | 6 | Alfa Wasserm ann - Холанди я | МТИ ООД | 3x1 | 76,80000 | 76,80 | 76,80 | 1 | 384,00 | 19,20 |
| 98 | Реакционни кювети | | 4x100 опаков ка | 10 | Alfa Wasserm ann - Холанди я | МТИ ООД | 4x1000 | 784,50000 | 784,50 | 784,50 | 1 | 6537,50 | 326,88 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--------------|-------------------------|----|--|------------|----------|-----------|--------|--------|---|---------|--------|
| 99 | Кулички за серум | | опаков ка x 1000 | 20 | Alfa Wasserm app - Холанди я | МТИ ООД | 1x1000 | 84,00000 | 84,00 | 84,00 | 1 | 1400,00 | 70,00 |
| 100 | Дилуент | | 2.5 л. | 60 | Alfa Wasserm app - Холанди я | МТИ ООД | 3x750ml. | 146,15000 | 131,52 | 131,52 | 1 | 6576,00 | 328,80 |
| 101 | Капачка за шише дилуент | | бр | 1 | Alfa Wasserm app - Холанди я | МТИ ООД | 1 | 538,32000 | 538,32 | 538,32 | 1 | 448,60 | 22,43 |
| 102 | ACE cap 500 | | опаков ка x 500 | 2 | Alfa Wasserm app - Холанди я | МТИ ООД | 1x500 | 172,80000 | 172,80 | 172,80 | 1 | 288,00 | 14,40 |
| 103 | СК-МВ | | R1(6x 6)+R2(6x6) | 8 | Alfa Wasserm app - Холанди я | МТИ ООД | 6x6 | 255,36000 | 255,36 | 255,36 | 1 | 1702,40 | 85,12 |
| 104 | ЛДХ | | опаков ка | 6 | Alfa Wasserm app - Холанди я | МТИ ООД | 5x10/2x6 | 178,56000 | 178,56 | 178,56 | 1 | 892,80 | 44,64 |
| 145 | Хеликобактер пилори - касети | серумен тест | опаков ка | 5 | Biosigma / Италия | МТИ ООД | 20 | 58,00000 | 58,00 | 58,00 | 1 | 241,67 | 12,08 |
| 146 | Микроалбуми н+стандарт /турбидиметр ичен метод/ | | оп. | 3 | BioSyste ms/ Испания | МТИ ООД | 1мл. | 8,40000 | 8,40 | 8,40 | 1 | 21,00 | 1,05 |

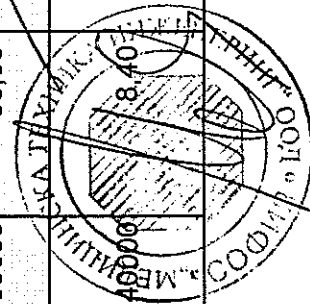

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|--|-----|---|----------------------|---------|----------------------|-----------|--------|---|---------|-------|
| 147 | Реактив за Гликиран Нв - A1C1 | | оп. | 3 | BioSyste ms/ Испания | МТИ ООД | 1x60мл. HbA1C direct | 552,00000 | 552,00 | 1 | 1380,00 | 69,00 |
| 148 | Калибратор за Гликиран Нв - A1C1 | | оп. | 2 | BioSyste ms/ Испания | МТИ ООД | 4x0.5ml. | 162,00000 | 162,00 | 1 | 270,00 | 13,50 |
| 149 | Контрол за Гликиран Нв - A1C1 | | оп. | 2 | BioSyste ms/ Испания | МТИ ООД | 0.5мл. | 48,00000 | 48,00 | 1 | 80,00 | 4,00 |
| 151 | Контролен серум СК, СК-МВ 2 x 2 мл | | бр. | 2 | BioSyste ms/ Испания | МТИ ООД | 1мл. | 16,80000 | 8,40 | 1 | 14,00 | 0,70 |
| 152 | Реваматоиден фактор | | бр. | 2 | BioSyste ms/ Испания | МТИ ООД | 150 | 0,18/тест | 27,00 | 1 | 45,00 | 2,25 |

79 710,71 3985,54

